

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 30.01.2026

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Hämostaseologie - D-Dimer (226):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

D-Dimer, qualitativ

D-Dimer, quantitativ

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:
10016936
Medizinische Hochschule Hannover
Institut für Klinische Chemie und Zentrallabor
Prof. Dr. Korbinian Brand
Carl-Neubergstr. 1
30625 Hannover

Düsseldorf, 03.03.2026



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

Ringversuch vom 30.01.2026

Sie haben an dem Ringversuch mit folgenden Untersuchungen teilgenommen

Hämostaseologie - D-Dimer (226):

D-Dimer, qualitativ

D-Dimer, quantitativ

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:
10016936
Medizinische Hochschule Hannover
Institut für Klinische Chemie und Zentrallabor
Prof. Dr. Korbinian Brand
Carl-Neubergstr. 1
30625 Hannover

Düsseldorf, 03.03.2026



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Auflistung und Bewertung der Ergebnisse

10016936: Medizinische Hochschule Hannover
 Institut für Klinische Chemie und Zentrallabor
 Prof. Dr. Korbinian Brand

Ringversuch vom 30.01.2026

Ringversuchsleiter: **Prof. Dr. med. Michael Spannagl**
 INSTAND e.V.
 Ubierstraße 20
 40223 Düsseldorf

Tel.: +49 211-1592 13 125
 Mail: m.spannagl@instand-ev.de

226

Hämostaseologie - D-Dimer

Analyt	Probe 226A- 260113	Einheit	Ihr Wert	Zielwert	ZW-Art	untere Grenze	obere Grenze	Abwei- chung	Z-Score	Kriterien erfüllt	
D-Dimer, quantitativ	-01 -02	µg/l	<190 19140	157 16964	SW SW	77.2 13838	237 20090	12.8%	0,827 1,39	+ +	

Analyt	Probe 226A- 260113	Ihre Einheit	Mitgeteilter Wert	Umrechnungs- faktor	Methode	Hersteller	Gerät	Cut Off	Testkit
D-Dimer, quantitativ	-01 -02	mg/l	<0.190 19.1	1000 1000	264	BW	SI08		77

Analyt	Probe 226A- 260113	Methode	Hersteller	Gerät	Ihre Angabe(n)	Korrekte Angabe(n)	ZW-Art	Kriterien erfüllt
D-Dimer, qualitativ	-01 -02				negativ (1) positiv (3)	negativ (1) grenzwertig, positiv (2,3)	MW MW	+ +

Individuelle Gesamtübersicht

10016936: Medizinische Hochschule Hannover
Institut für Klinische Chemie und Zentrallabor
Prof. Dr. Korbinian Brand

Ringversuch vom 30.01.2026


226

Hämostaseologie - D-Dimer

D-Dimer, quantitativ (µg/l, N = 241)									
Kollektiv	Probe 226A-260113	Zielwert	Bewertungs- bereich		Teilnehmerkollektiv			Quote (%)	
					MW	VK	Anz.	Probe	ges.
TK.70, , R.VCB	-01	222	112	- 332	222	24.7	33	97.0	87.9
	-02	8220	7046	- 9394	8220	7.14	33	90.9	
D-Dimer HS500	-01	205	117	- 293	205	21.4	42	92.9	85.7
	-02	17723	14795	- 20651	17723	8.26	42	92.9	
TK.93, 149, 291	(1) -01		Probe nicht bewertet				4		
	-02		Probe nicht bewertet				4		
OSR60135 D Dimer	(1) -01		- <=250		137	29.1	5		
	-02	3596	3222	- 3970	3596	5.20	5		
D Dimer FS (Diasys)	(1) -01	350	350	- 350	350	0.000	1		
	-02	1960	1960	- 1960	1960	0.000	1		
TK.214, 281	(1) -01	152	31.6	- 272	152	39.6	4		
	-02	13276	7152	- 19400	13276	23.1	4		
D-Dimer Tinaquant	-01		- <=250		191	22.4	21	90.5	81.0
	-02	3875	3531	- 4219	3875	4.44	21	85.7	
Innovance D-Dimer	-01	157	77.2	- 237	157	25.4	69	98.6	91.3
	-02	16964	13838	- 20090	16964	9.21	69	92.8	
TK.71, 190	-01	95.6	54.4	- 137	95.6	21.5	11	90.9	90.9
	-02	5728	4164	- 7292	5728	13.7	11	100	
TK.91, 270	(1) -01	95.4	20.0	- 209	95.4	59.5	5		
	-02	3250	2310	- 4190	3250	14.5	5		
Quantia D Dimer	(1) -01		Probe nicht bewertet				4		
	-02		Probe nicht bewertet				4		
G.RO09, RO58	-01		- <=100		100	0.000	14	100	100
	-02		>=4000		4000	0.000	14	100	
Radiometer AQT 90	-01	186	152	- 220	186	9.19	23	95.7	95.7
	-02	6067	5225	- 6909	6067	6.94	23	95.7	
D Dimer IL	(1) -01	189	137	- 241	189	13.7	5		
	-02	5886	1936	- 9836	5886	33.6	5		

(1) Statistisch valide Bewertung mit dem Konsenswert in Einzelfällen nicht gegeben, da Kollektivgröße < 8 Werte.

Bestehensquote: 90,6%

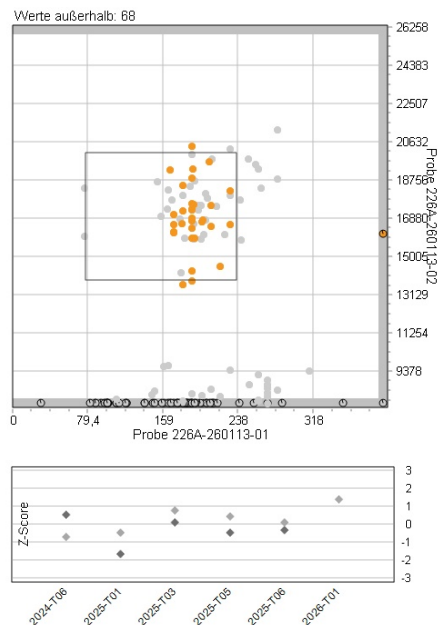



D-Dimer, qualitativ (N = 116, Bestehensquote: 99,1%)

Probe 226A-260113-01

Kollektiv	negativ (1)	positiv (3)	gesamt
alle Hersteller	115 ●	1	116

Probe 226A-260113-02

Kollektiv	negativ (1)	positiv (3)	gesamt
alle Hersteller	1	115 ●	116

Der Punkt entspricht dem korrekten Ergebnis, der horizontale Balken entspricht Ihrer Angabe, der vertikale Balken entspricht Ihrem Kollektiv